


Oracle™ 452 ORAL MASK

MULTI PATIENT INSTRUCTIONS FOR USE

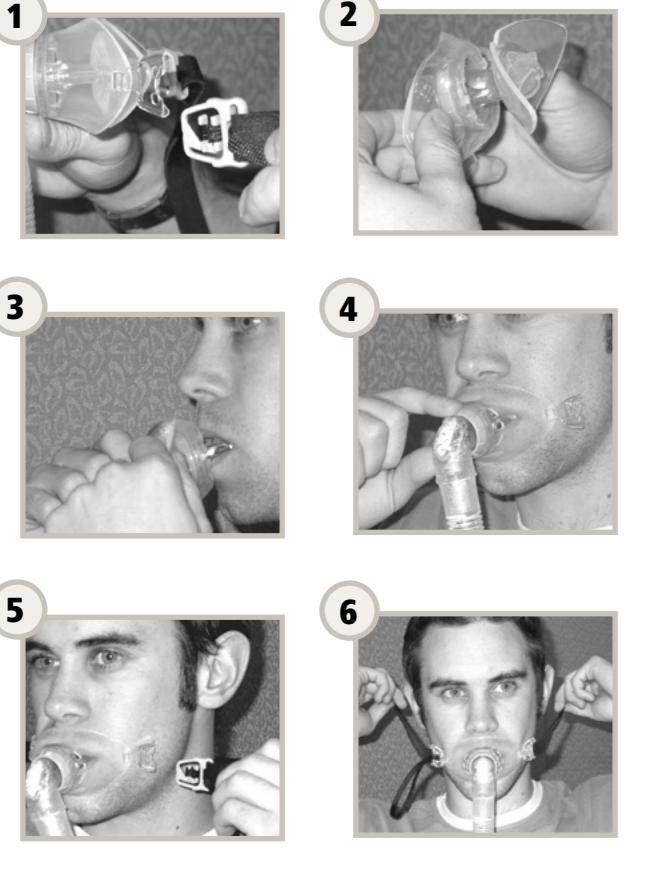

ORACLE™ 452 MUNDMASKE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR PATIENTEN

Die Oracle™ Mundmaske wird für den Gebrauch durch einen oder mehrere erwachsenen Patienten mit dem deren CRP/Bi-Level-Respiratortherapie direkt verordnet wurde. Um eine effektive Therapie zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Oracle™ Mundmaske mit einem Fisher & Paykel Healthcare CRP-System inkl. ThermoSmart™-Technologie (Schlauchheizung) zu verwenden.

ANPASSEN DER MASKE

- Zusammensetzen der Maske, siehe Abbildung.**
- Verbinden Sie Maske und Kopftücher. Wenn Sie eine der Schnallen schließen.
- Öffnen Sie die Schnallen während Sie die Maske ansetzen.
- Führen Sie den Silikon-Einsatz in den Mund ein, eine Seite nach der anderen. Er sollte im Guarnierungsbereich zwischen Wangen und Zähnen sitzen. Die Lippen sollten den Silikon-Einsatz bequem umklammern.
- Klappen Sie die SnapFlap™-Abdeckung wieder in die Normalposition und korrigieren Sie gegebenenfalls den festen Stand der Maske durch Drehen des Deckrings .
- Schließen Sie die Kopftücher abgedichtet um den Hals legen sollte.
- Verwenden Sie die Nasenstopfen wenigen für die Zeitdauer der ersten zwei Wochen.
- Stellen Sie sicher, dass die Schnallen geschlossen sind.
- Schließen Sie das CRP/Bi-Level auf, dass auf den vorherigen Druck eingestellt ist.

TIPPS FÜR GÜTEN SITZ

- Wenn die Maske um die Zähne herum liegen aufweist, ist die SnapFlap™-Abdeckung durch Draufsetzen der Schnallen zu ziehen.
- Wenn der Problem weiterbesteht, probieren Sie den kleinen Silikon-Einsatz, der mit der Oracle™ Mundmaske mitgeliefert wird.
- Es kann vorkommen, dass ein Tragkomfort oder leichtes Maskenheilung die Kopftücherung mit der Oracle™ Mundmaske zu verwenden. Die Benutzung der Kopftücherung ist jedoch ein Einzelgabe optional.
- Haben Sie keine Zeit zu fressen?
- Zum Lösen der Schnallen einfach an der Lesebüschel ziehen.
- Wenn die Nasenstopfen nicht weiter benutzt werden soll, kann die SnapFlap™-Abdeckung einfach an beiden Schnallen ausgehakt werden.

BENUTZUNG DER MASKE

- Oracle™ CRP/Bi-Level-Therapie benötigt unbedingt optimale Feuchtigkeitswerte, da die Nase als Hauptfeuchtigkeitsquelle fungieren wird. Für bessere Resultate empfiehlt Fisher & Paykel Healthcare ein CRP-System mit ThermoSmart™-Technologie (Schlauchheizung).
- WARMHOLDFEUCHTUNG MUSS immer in Verbindung mit der Oracle™-Maske verwendet werden.**
- Stellen Sie sicher, dass genug Wasserr in Ihrer Kammer ist.
 - Erhöhen Sie die Feuchtigkeitssablage ihres Bettfleckers (Temperatur hoch, Schlüssel isolieren).
 - Wenn Sie immer noch unter Trockenheit leiden, könnte eine kleine Luftfeuchtigkeit an der Nase bestehen.
 - Nasenstopfen können diese Leckage schließen und den Mund feucht halten.

TROCKENHEIT

Wenn Sie einen trockenen Mund haben, versuchen Sie Folgendes:

- Erhöhen Sie die Feuchtigkeitssablage ihres Bettfleckers (Temperatur hoch, Schlüssel isolieren).
- Wenn Sie immer noch unter Trockenheit leiden, könnte eine kleine Luftfeuchtigkeit an der Nase bestehen.
- Nasenstopfen können diese Leckage schließen und den Mund feucht halten.

MASSENSTOPFEN

- Mit Nasenstopfen ist es leichter, den Mund trocken zu halten. Nach zwei Wochen ist Ihr Weiterverwendung optional. Sie sollten unter folgenden Bedingungen jedoch Nasenstopfen verwenden:
- Bei trockenem Mund
 - Nasenstopfen
 - Nasenstopfen
 - Schlechter Schlaf

GEBAUCHSANWEISUNGEN

- Nasenstopfen sind in den Größen **L1** und **L2**.
- Entnehmen Sie die mittig liegenden Silikon Nasenstopfen und führen Sie sie so weit in die Nase ein, dass der untere Rand gerade mit dem inneren Rand der Nasenlöcher abschlägt.
- Die Stopfen sollten bequem in der Nase sitzen und die Luftzufuhr unterbrechen. Andernfalls ist eine andere Größe **L1** zu verwenden.
- Benutzen Sie die Oracle™ Mundmaske ganz normal, nur mit eingesetzten Nasenstopfen.

ZUSAMMENSETEZEN DER MASKE

Die Oracle™ Mundmaske ist gebrauchsreif zusammengesetzt. Nach der Reinigung sind jedoch diese Anleitungen zum Zusammensetzen zu befolgen.

- Führen Sie das Ende des Mitteltelles und den Silikon-Einsatz ein. Prüfen Sie, dass es ganz über die gesamten Kunststoffteile geöffnet ist.
- Drehen Sie die Schnallen und die SnapFlap™-Abdeckung auf das Mitteltell .
- Verbinden Sie das Winkelteil mit dem Mitteltell und den Flexischlauch mit dem Winkelteil .
- Verbinden Sie das Rücktemperaturregler mit dem Rückschlüssel .

LEINIGEN DER MASKE SICHER

Zur Gewährleistung von inhaltender Sicherheit und bequemem Sitz Ihrer Oracle™ Mundmaske:

- VOR GEBAUCH:**
- Waschen Sie das Kopftuch mit lauem Wasser mit mildem Waschmittel. Lassen Sie es nicht länger als 10 Minuten einwirken. Spülen Sie es dann gründlich in klarem Wasser aus. Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an der Luft trocknen lassen.

VOR JEDER GEBAUCH:

- Prüfen Sie die Maske auf Verschleiß. Benutzen Sie sie, wenn sie Verschleiß oder Beschädigungen aufweist.
- Prüfen Sie das Rücktemperaturregler und die SnapFlap™-Abdeckung vom Mitteltell .
- Waschen Sie alle Teile außer Kopftuch und Verteiler in lauwarmem Wasser mit mildem Seife. Lassen Sie es nicht länger als 10 Minuten einwirken. Spülen Sie es dann gründlich in klarem Wasser und trocknen Sie es an der Luft trocknen lassen.

NACH JEDER GEBAUCH:

- Waschen Sie alle Teile außer Kopftuch und die SnapFlap™-Abdeckung vom Mitteltell .
- Waschen Sie alle Teile außer Kopftuch und Verteiler in lauwarmem Wasser mit mildem Seife. Lassen Sie es nicht länger als 10 Minuten einwirken. Spülen Sie es dann gründlich in klarem Wasser und trocknen Sie es an der Luft trocknen lassen.

ANMERKUNG: Das Winkelteil darf nicht gewaschen oder abgespült werden. Setzen Sie es sofort wieder an.

ANMERKUNG: Das Winkelteil darf nicht gewaschen oder abgespült werden. Setzen Sie es sofort wieder an.

ANMERKUNG: Das Winkelteil darf nicht direkt in direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.

Obige Bedingungen können die Maske beschädigen oder Ihre Haltbarkeit verkürzen.

Wenn die Oracle™ Mundmaske verschleift oder Risse aufweist, ist sie sofort zu ersetzen.

ACHTUNG:

- Die Maske darf länger als 10 Minuten einweichen.
- Die Maske darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Die Maske darf nicht mit Produkten gewaschen, die Alkohol, Chlor, antibakterielle Wirkstoffe oder andere aggressive Substanzen enthalten.
- Die Maske darf nicht in direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.

Obige Bedingungen können die Maske beschädigen oder Ihre Haltbarkeit verkürzen.

Wenn die Oracle™ Mundmaske verschleift oder Risse aufweist, ist sie sofort zu ersetzen.

GARANTIE UND ENTSORGUNG

- GARANTIE:**
- Fisher & Paykel Healthcare garantiert, dass die Maske laugennahmen Schaumstoffe und Materialverluste bei unentzündlichen Gelegenheiten für die Werkstoff- und Verarbeitungsmaßnahmen ist und für die Lebensdauer von 12 Monaten. Fisher & Paykel Healthcare stellt Ihnen ein neues Gerät oder entsprechende Produktspezifikationen angehörige Leistungsergebnisse vor. Diese Garantie erfolgt vorbehaltlich der Einschränkungen und Ausnahmen, die im Detail unter <http://www.fisherpak.com/usa/product/Warranty.aspx> zu finden.

ENTSORGUNG:

Diese Garantie enthält keine gefährlichen Stoffe und kann mit dem normalen Müll entsorgt werden.

SAUERSTOFF/DRUCKMESS-ADAPTER

Wenn Druckmessungen und/oder austauschbarer Sauerstoff gewünscht werden, ist ein Adapter für Sauerstoff und Druckmessungen erhältlich. (Bestell-Nr. 900H452)

- Schließen Sie das große Ende des Adapters an das Rücktemperaturreglerventil an.
- Öffnen Sie das Portteilchen und setzen Sie Druck- und/oder Sauerstoffschläuche fest auf den/die entsprechenden Schnallen .

Die beiden Ports sind identisch; beide können für Sauerstoff oder Druckmessung benutzt werden. Nur die Portteile müssen für den austauschbaren Sauerstoffadapter in Ablösung von Druck, Atemregelung und Leckgegenwart variieren.

ANMERKUNG: Das Winkelteil darf nicht gewaschen oder abgespült werden, wenn das Werkstoffmaterial entfernt wird. Der Ventilator sollte nicht gewaschen oder abgespült werden. Setzen Sie es sofort wieder an.

ANMERKUNG: Das Winkelteil darf nicht gewaschen oder abgespült werden. Setzen Sie es sofort wieder an.

ANMERKUNG: Das Winkelteil darf nicht direkt in direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.

Obige Bedingungen können die Maske beschädigen oder Ihre Haltbarkeit verkürzen.

Wenn die Oracle™ Mundmaske verschleift oder Risse aufweist, ist sie sofort zu ersetzen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

RECHEN-/AUSATMUNGSKONTROLLE

Wenn Druckentlastungen und/oder austauschbarer Sauerstoff gewünscht werden, ist ein Adapter für Sauerstoff und Druckmessungen erhältlich. (Bestell-Nr. 900H452)

- Schließen Sie das große Ende des Adapters an das Rücktemperaturreglerventil an.
- Öffnen Sie das Portteilchen und setzen Sie Druck- und/oder Sauerstoffschläuche fest auf den/die entsprechenden Schnallen .

Die beiden Ports sind identisch; beide können für Sauerstoff oder Druckmessung benutzt werden. Nur die Portteile müssen für den austauschbaren Sauerstoffadapter in Ablösung von Druck, Atemregelung und Leckgegenwart variieren.

ANMERKUNG: Das Winkelteil darf nicht gewaschen oder abgespült werden, wenn das Werkstoffmaterial entfernt wird. Der Ventilator sollte nicht gewaschen oder abgespült werden. Setzen Sie es sofort wieder an.

ANMERKUNG: Das Winkelteil darf nicht gewaschen oder abgespült werden. Setzen Sie es sofort wieder an.

ANMERKUNG: Das Winkelteil darf nicht direkt in direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.

Obige Bedingungen können die Maske beschädigen oder Ihre Haltbarkeit verkürzen.

Wenn die Oracle™ Mundmaske verschleift oder Risse aufweist, ist sie sofort zu ersetzen.

REINIGUNG / SCHMUTZENTFERNUNG

Vor dem Säubern die Schmutzmaske zu entfernen, indem die Maske in ihrer Bestandsliste aufgeführt wird.

Sofern die Maske mit einer Körnung verseilt ist, kann die Körnung mit einem feinen Zahnbürste entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.


Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

Sofern die Maske mit einem Haarschäler verseilt ist, kann die Körnung mit einem Haarschäler entfernt werden.

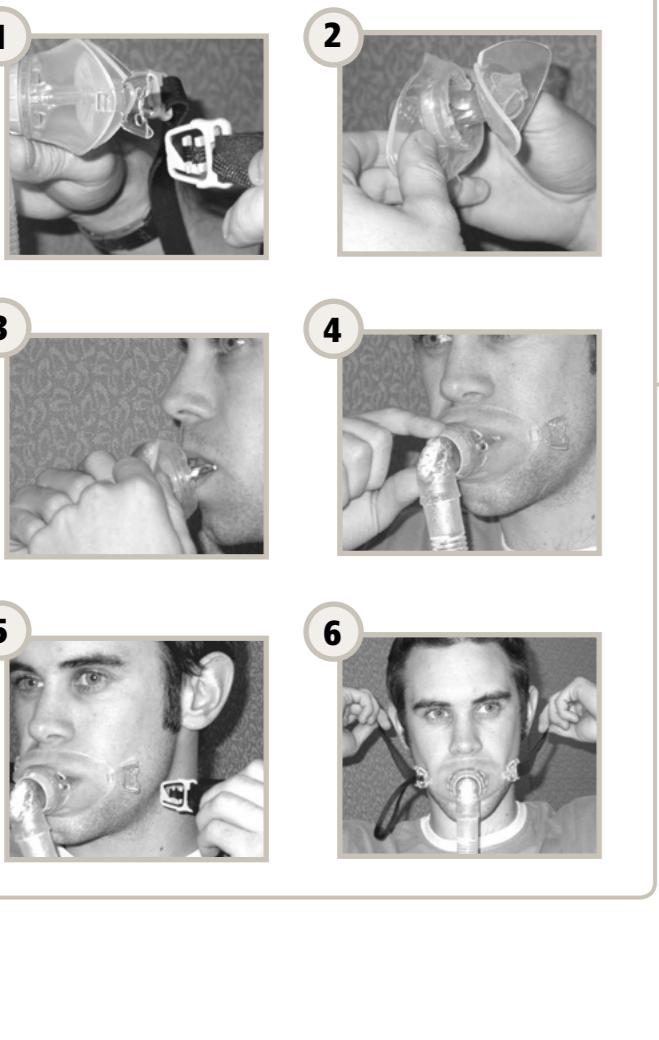

FITTING YOUR MASK

Refer to the mask assembly diagram.

- 1 Attach Headgear by re-connecting one of the clips [1].
- 2 Pull the SnapLip™ Cover [A] back to the retracted position.
- 3 Insert the Silicone Seal [C] into the mouth, one side at a time. It should sit in the gum region between the cheeks and the teeth. Move your lips around so they fit comfortably all the way over the Silicone Seal [C].
- 4 Return the SnapLip™ Cover [A] to its normal position, and adjust the mask tightness by rotating the Dial [D] clockwise.
- 5 Insert the Headgear [H] into the Headgear slot [B] and string loosely around base of neck, re-connect clip.
- 6 Adjust Headgear [H] to fit and remove stock.
- 7 Use nasal plug [F] for at least the first two weeks of use. Refer to Nasal Plug Instructions.
- 8 Connect to CPC/VN/Level machine set at prescribed pressure.

FITTING TIPS

- If the mask looks around the teeth, tighten the SnapLip™ Cover [A] by rotating the Dial [D].
- If problems persist, try using the large Silicone Seal, which is included in your Oracle™ Oral Mask box.
- It is recommended to use the Headgear with your Oracle™ Oral Mask for optimum comfort and performance. However, if preferred, it is optional to discontinue use of Headgear.
- Do not overtighten Headgear.
- To release clip, simply pull on the Easy-Release Cord [E].
- If discontinuing use of Headgear, simply remove by unhooking both clips from SnapLip™ Cover [A].

USING YOUR MASK

For CPC/VN/Level bypasses the nasal airway and requires optimum humidity. For best results, refer to Fisher & Paykel Healthcare Series CPCAP system with thermosmart™ Technology.

Heated Humidification MUST be used in conjunction with the Oracle™ Oral mask.

- 1 Ensure water chamber is filled.
- 2 Breathe through your mouth only.
- 3 Use nasal plug for at least the first two weeks.

DRYNESS

If you are experiencing a dry mouth try the following:

- 1 Increase the humidity on your machine.
- 2 If still experience dryness, it could be due to a small air leak out of the nose. Nasal Plugs [F] will restrict this leak and help to retain some moisture in your mouth.

NASAL PLUGS

Nasal Plugs are used to aid in the training of natural mouth breathing. It is optional to discontinue use after the first few weeks. However, use Nasal Plugs if you experience any of the following:

- Dryness
- Nasal leak
- Poor sleep quality

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1 Insert Nasal Plugs [F] in come in three sizes, S / M / L.
- 2 Insert medium size Silicone Nasal Plugs into nose so that the base of the plugs are just inside the nostril.
- 3 The plug should fit comfortably inside the nose and should seal off the flow of air. If not content, try the other sizes.
- 4 Use the Oracle™ Oral Mask as normally would, with the Nasal Plugs inserted.

ASSEMBLING YOUR MASK

Your Oracle™ Oral Mask comes assembled and ready to use. However, when you need to clean your mask follow these instructions for reassembly:

- 1 Insert the rest of the Centre Body [C] into the Silicone Seal [A]. Ensure it is pulled up over all of the plastic plugs properly.
- 2 Orient SnapLip™ Cover [A] into position shown. Retract Dial [D] to screw onto Centre Body [C].
- 3 Connect Elbow [E] to the Centre Body [C] and the Flexitube [F] to the Elbow [E].
- 4 Connect the Non-Rebreathing Valve [G] to the Flexitube [F].

CLEANING YOUR MASK AT HOME

To ensure continuing safety and comfort for your Oracle™ Oral Mask:

BEFORE FIRST USE:

- 1 Wash the Headgear in warm soapy dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water and allow to air dry out of direct sunlight.
- 2 Inspect the mask for damage. Do not use if damaged.
- 3 Inspect the Non-Rebreathing Valve [G]. Ensure the silicone flaps are present and undamaged.

AFTER EACH USE:

- 1 Disassemble the Silicone Seal [A] & SnapLip™ Cover [A] from the Centre Body [C].
- 2 Wash all parts except the Headgear [H] and Diffuser [I] in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water and allow to air dry out of direct sunlight.
- 3 Alternatively, the Silicone Seal [A] may be washed for 10 minutes in a clean solution of approximately 30 mL of water and 10 mL of 5% antiseptic, methowax. Rinse in fresh water and allow to air dry out of direct sunlight.

NOTE: Do NOT immerse Elbow [E] into Diffuser material [I] as this has been removed.

The Diffuser [I] should not be washed or cleaned. Simply replace it with a new diffuser if it becomes noisy or if it does not fit correctly. It is recommended to change the Diffuser [I] every three months. Small debris may appear on the Diffuser [E] – this does not affect its performance. The Oracle™ Oral Mask may be used with or without the Diffuser [I] and Diffuser Cap [J].

EVERY 7 DAYS:

- 1 Hand wash Headgear in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water and allow to air dry out of direct sunlight. It is not necessary to remove the Clip [E] from the headgear when washing.

CAUTION:

- Do not soak the mask for longer than 10 minutes.
- Do not wash the mask in the dishwasher.
- Do not clean the mask with products containing alcohol, chlorine, antibacterial agents or bleach.
- Do not store the mask in direct sunlight.

The above actions may deteriorate or damage the mask and shorten its life.

If your Oracle™ Oral mask weakens or cracks, discontinue use immediately.

WARRANTY AND DISPOSAL

WARRANTY STATEMENT:

Fisher & Paykel Healthcare warrants that the mask (excluding foams and material diffusers), when used in accordance with its instructions for use, shall be free from defects in workmanship and materials for a period of 90 days from the date of purchase. See the manufacturer's official published product specifications for a period of 90 days from the date of purchase. This warranty is subject to the limitations and exceptions set out in detail in <http://www.fphcare.com/us/product/warranty.aspx>

DISPOSAL:

This device does not contain any hazardous substances and may be disposed of with general waste.

OXYGEN/PRESSURE PORT CONNECTOR

If pressure readings and/or additional oxygen are required, an Oxygen/Pressure Port Connector is available. Product #900HC452.

1. Connect the large end of the connector [P] to the Non-Rebreathing Valve [G] and the small end of the connector to the main breathing tube [E].

2. Open the Port Cap [S] and place the Pressure or Oxygen Port [P] firmly over the Port [S].

The Two Ports are identical; either Port may be used for oxygen or pressure measurement. Only the Port Cap [S] needs to be replaced when changing from oxygen to pressure.

AFTER EACH USE:

1. Disconnect the silicone Seal [A] & SnapLip™ Cover [A] from the Centre Body [C].

2. Wash all parts except the Headgear [H] and Diffuser [I] in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water and allow to air dry out of direct sunlight.

3. Alternatively, the Silicone Seal [A] may be washed for 10 minutes in a clean solution of approximately 30 mL of water and 10 mL of 5% antiseptic, methowax. Rinse in fresh water and allow to air dry out of direct sunlight.

NOTE: Do NOT immerse Elbow [E] into Diffuser material [I] as this has been removed.

The Diffuser [I] should not be washed or cleaned. Simply replace it with a new diffuser if it becomes noisy or if it does not fit correctly. It is recommended to change the Diffuser [I] every three months. Small debris may appear on the Diffuser [E] – this does not affect its performance. The Oracle™ Oral Mask may be used with or without the Diffuser [I] and Diffuser Cap [J].

EVERY 7 DAYS:

1. Hand wash Headgear in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water and allow to air dry out of direct sunlight. It is not necessary to remove the Clip [E] from the headgear when washing.

CAUTION:

- Do not soak the mask for longer than 10 minutes.
- Do not wash the mask in the dishwasher.
- Do not clean the mask with products containing alcohol, chlorine, antibacterial agents or bleach.
- Do not store the mask in direct sunlight.

The above actions may deteriorate or damage the mask and shorten its life.

If your Oracle™ Oral mask weakens or cracks, discontinue use immediately.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EXHAUST FLOW INFORMATION

All flow rates listed in the chart below have been exhaust flow rates to exit the air that you exhale from the mask. The Oracle™ Oral Mask incorporates the unique Fisher & Paykel Healthcare Diffuser system that is designed to effuse the air that you exhale. This noticeably reduces dust and noise.

The Diffuser [I] does not significantly reduce the amount of air flowing from the mask, therefore the mask can be worn with or without the Diffuser [I] and the exhaust air is not blocked by any object.

This controlled flow reduces the risk of clogging the non-rebreathing valve.

Explanation of Warning: When the CPC/VN/Level device is in operation, and the oxygen flow is high, oxygen entering the ventilation circuit may accumulate within the Charpy® mouthpiece enclosure. Oxygen accumulated in the Charpy® mouthpiece enclosure may result in a risk of fire.

Warning: Do not smoke while in proximity to or vicinity of someone using oxygen with this mask.

Warning: Do not use Polyvinyl Chloride (PVC) pressure and/or oxygen tubing. Use silicone tubing instead.

Explanation of Warning: Contact with PVC can cause premature cracking of parts.

CONNECTEUR DE PRISE DE PRESION / OXYGÈNE

Un record de pression (oxygène et/ou gaz) est disponible. (Produit #900HC452)

1. Connectez l'extrémité large du connecteur [P] à la valve anti-réinhalation [G] et l'autre extrémité du connecteur ou tube respiratoire principal [I].

2. Ouvrez le bouchon [S] et placez le port de pression ou d'oxygène [P] sur la partie [S].

Lorsque les deux ports sont identiques, vous pouvez consigner l'un l'autre pour la mesure d'oxygène ou de pression. Veuillez suivre les directives suivantes.

• Remarque : Lors d'un entraînement en oxygène via un débit fixe, la concentration respirée varie en fonction du réglage de la pression, des caractéristiques ventilatoires du masque, et des flux.

• Avertissement : Assurez-vous d'avoir fermement l'entraînement en oxygène lorsque le CPC/VN/Level est à l'arrêt.

Expliquer de l'entraînement : Lorsque le CPC/VN/Level est à l'arrêt, le CO2 échappe de la valve anti-réinhalation et l'oxygène peut s'accumuler dans les circuits de la CPC/VN/Level augmentant ainsi le risque d'incendie.

• Avertissement : Ne jamais fumer en présence à proximité d'oxygène.

• Avertissement : Ne pas utiliser de tuyau de pression et/ou d'oxygène en polychlorure de vinyle (PVC). Utiliser du tuyau en silice à la place.

Expliquer de l'entraînement : Le contact avec du PVC peut prématurément fissurer les ports de pression et/ou d'oxygène.

USOS PARA SEMIÁNEA:

1. Lavar o la mano el Amano con jabón y agua limpia en agua templada. Evitar dejar en remojo más de 10 minutos, después de lavar con agua limpia y dejar seco fuera del alcance de la luz directa del sol.

ANTES DE CADA USO:

1. Lavar la cara y las manos de la cara con agua tibia limpia. No permitir que el agua deje de fluir dentro de la boca.

2. Verificar si la válvula anti-rebreathing está dañada.

3. Verificar si la válvula anti-rebreathing está dañada.

4. Desconectar el tubo de la boca.

5. Desconectar el tubo de la boca.

6. Desconectar el tubo de la boca.

7. Desconectar el tubo de la boca.

8. Desconectar el tubo de la boca.

9. Desconectar el tubo de la boca.

10. Desconectar el tubo de la boca.

11. Desconectar el tubo de la boca.

12. Desconectar el tubo de la boca.

13. Desconectar el tubo de la boca.

14. Desconectar el tubo de la boca.

15. Desconectar el tubo de la boca.

16. Desconectar el tubo de la boca.

17. Desconectar el tubo de la boca.

18. Desconectar el tubo de la boca.

19. Desconectar el tubo de la boca.

20. Desconectar el tubo de la boca.

21. Desconectar el tubo de la boca.

22. Desconectar el tubo de la boca.

23. Desconectar el tubo de la boca.

24. Desconectar el tubo de la boca.

25. Desconectar el tubo de la boca.

26. Desconectar el tubo de la boca.

27. Desconectar el tubo de la boca.

28. Desconectar el tubo de la boca.

29. Desconectar el tubo de la boca.

30. Desconectar el tubo de la boca.

31. Desconectar el tubo de la boca.

32. Desconectar el tubo de la boca.

33. Desconectar el tubo de la boca.

34. Desconectar el tubo de la boca.

35. Desconectar el tubo de la boca.

36. Desconectar el tubo de la boca.

37. Desconectar el tubo de la boca.

38. Desconectar el tubo de la boca.

39. Desconectar el tubo de la boca.

40. Desconectar el tubo de la boca.

41. Desconectar el tubo de la boca.

42. Desconectar el tubo de la boca.

43. Desconectar el tubo de la boca.

44. Desconectar el tubo de la boca.

45. Desconectar el tubo de la boca.

46. Desconectar el tubo de la boca.

47. Desconectar el tubo de la boca.

48. Desconectar el tubo de la boca.

49. Desconectar el tubo de la boca.

50. Desconectar el tubo de la boca.

51. Desconectar el tubo de la boca.

52. Desconectar el tubo de la boca.

53. Desconectar el tubo de la boca.

54. Desconectar el tubo de la boca.

