

HOFFRICHTER

Quality makes the Difference ■■■■

Nasal Pillow 4in1 Maske

Größen/Sizes: XS, M, S, L



Gebrauchsanleitung
User's Manual

SYMBOLE AUF DER VERPACKUNG



Gebrauchsanleitung
beachten



Datum der Herstellung



Produkt ist latexfrei



Chargenbezeichnung



Artikelnummer



Verwendbar bis



Produkt ist nur für den Gebrauch durch einen Patienten vorgesehen


BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Die Maske ist für die Anwendung bei erwachsenen Patienten (> 30 kg) vorgesehen, denen eine CPAP- oder Bilevel-Atemtherapie verordnet wurde und die eine Einweisung durch einen Arzt erhalten haben. Sie wird in Verbindung mit Atemtherapiegeräten zu Hause, im Krankenhaus und in PÉegeeinrichtungen verwendet.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN


- einfach zu handhaben, zusammenzubauen und zu reinigen
- 4 verschieden große Nasenpolster für passgenauen Sitz (XS, S, M und L)
- um 360° drehbarer Schlauchanschluss mit flexiblen Therapieschlauch
- Sehr leises Luftauslassventil

BESTANDTEILE DER NASAL PILLOW 4in1 MASKE

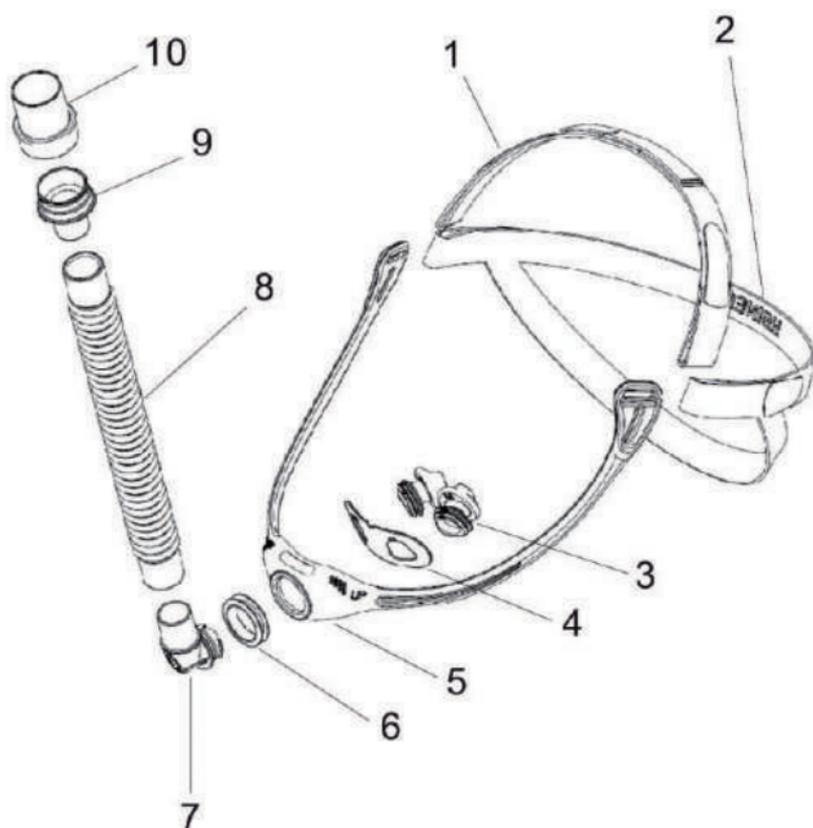


Nr.	Beschreibung
1	Oberes Kopfband
2	Hinteres Kopfband
3	Nasenpolster (XS, S, M, L)
4	Nasenpolstereinsatz
5	Maskenrahmen
6	Verbindungsring
7	Kniestück
8	Therapieschlauch
9	Drehgelenk
10	Schlauchanschluss


ZUSAMMENBAU DER NASAL PILLOW 4 in1 MASKE

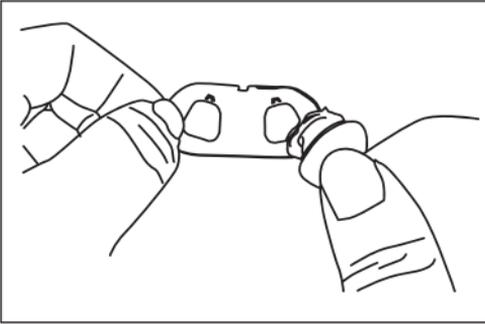

Drücken Sie die Nasenpolster in den Nasenpolstereinsatz.

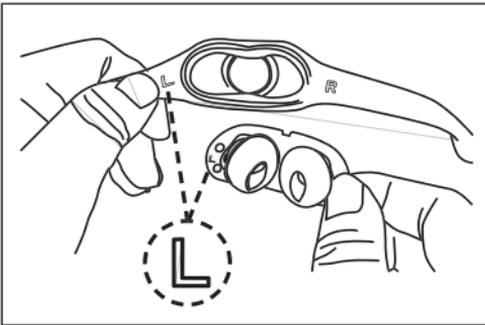


Drücken Sie den Nasenpolstereinsatz in die Öffnung an der Innenseite des Maskenrahmens.

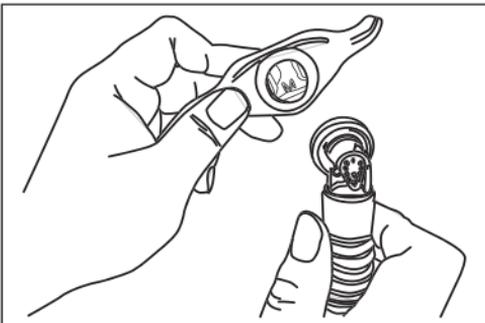


Drücken Sie das Kniestück des Therapieschlauchs in die Öffnung des Maskenrahmens.


ZUSAMMENBAU DER NASAL PILLOW 4in1 MASKE

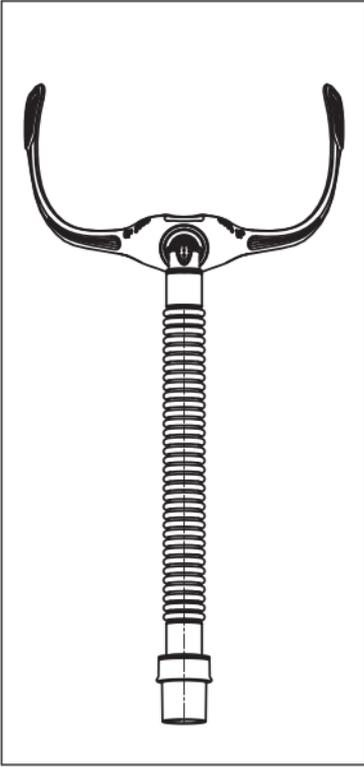

Vorderansicht

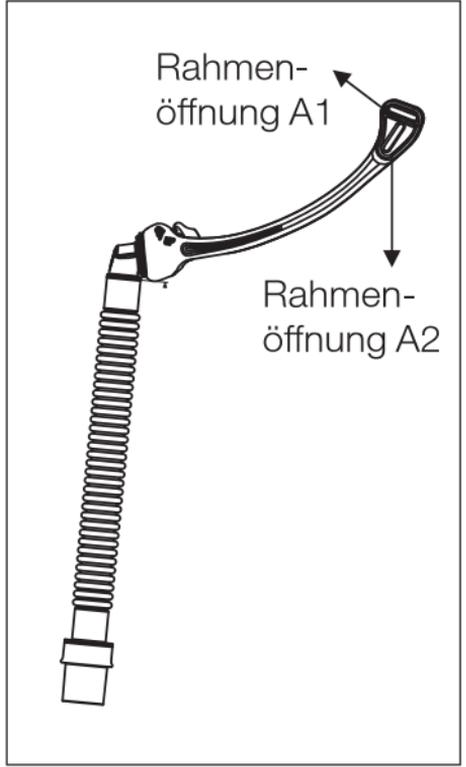


Seitenansicht

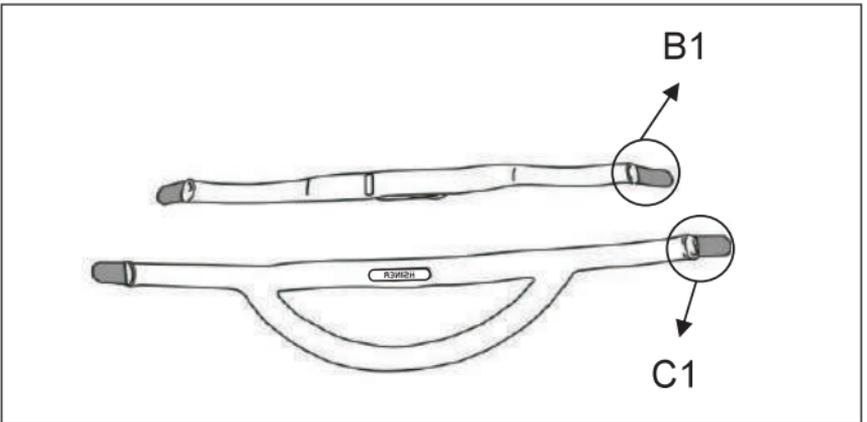


Kopfbänder


ZUSAMMENBAU DER NASAL PILLOW 4 in1 MASKE

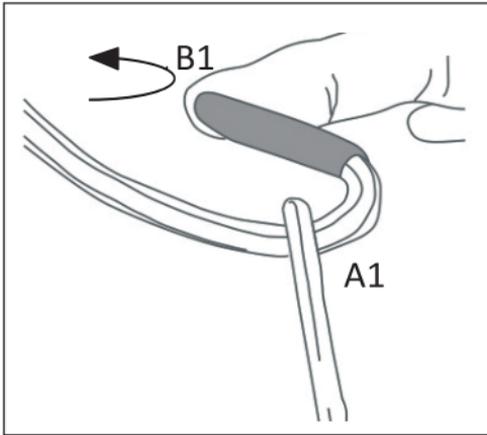

Ziehen Sie das Klettband B1 durch die Maskenrahmenöffnung A1 und befestigen Sie es.

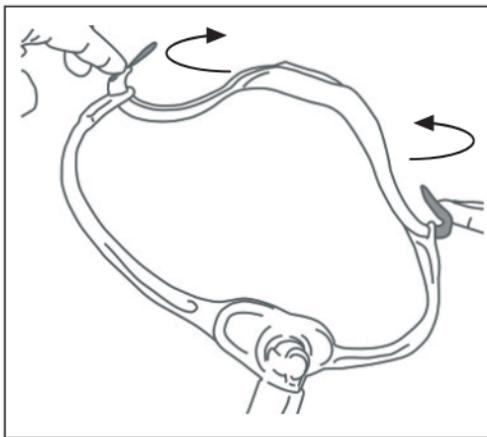


Führen Sie das Gleiche auf der anderen Seite durch.

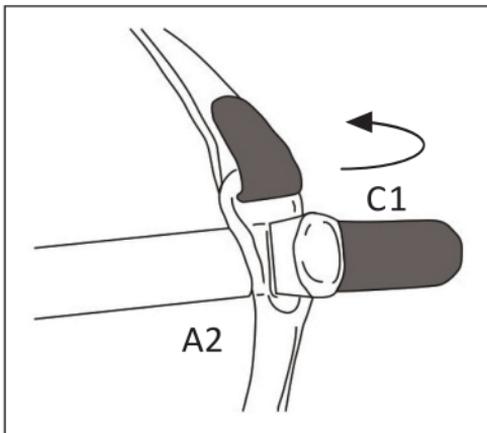


Ziehen Sie auf der anderen Seite das Klettband C1 durch den Maskenrahmenöffnung A2 und befestigen Sie es.

ZUSAMMENBAU DER NASAL PILLOW 4in1 MASKE

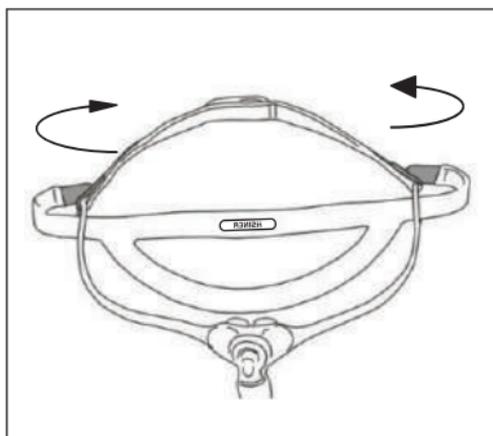

Führen Sie das Gleiche auf der anderen Seite durch.

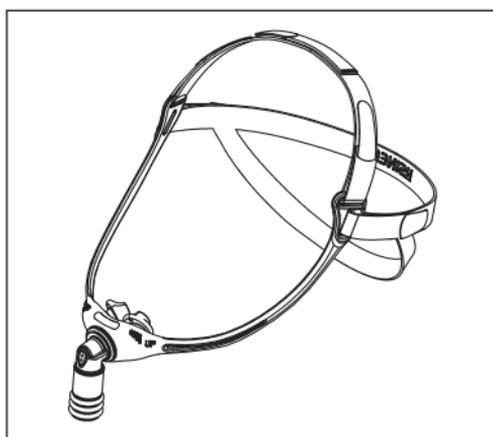

Beide Kopfbänder sind nun angebracht.




Führen Sie die Nasenpolster zur Nase und ziehen Sie dann die Kopfbänderung über den Kopf.


ZUSAMMENBAU DER NASAL PILLOW 4 in1 MASKE



Stellen Sie die Klett-
bänder des oberen
Kopfbandes so ein,
dass eine angenehme
Spannung erreicht
wird.

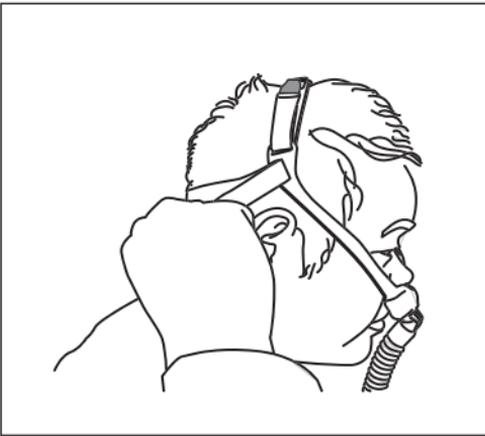

Stellen Sie die Klett-
bänder der hinteren
Kopfbänder so ein,
dass eine bequeme
Spannung erreicht
wird.

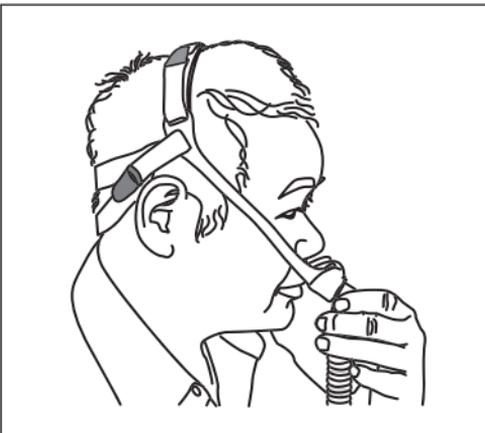


Richten Sie den Mas-
kenrahmen so aus,
dass die Nasenkis-
sen angenehm auf den
Nasenlöchern sitzen.


ZUSAMMENBAU DER NASAL PILLOW 4in1 MASKE



Die Maske ist jetzt einsatzbereit und das freie Ende des Therapieschlauchs kann mit dem Therapieschlauch verbunden werden.

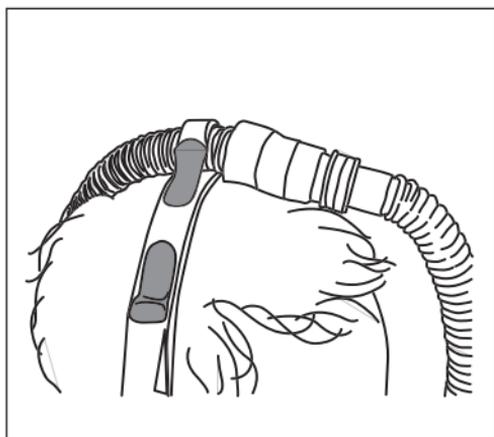

Es ist möglich, den Therapieschlauch mit dem zusätzlichen Klettverschluss am oberen Kopfband zu **exieren**.

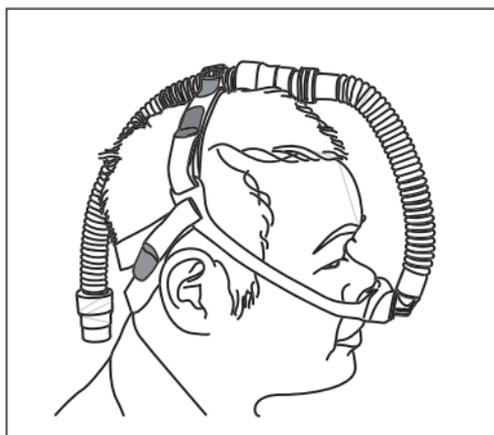

Achten Sie bei der Befestigung auf ausreichende Schlauchlänge zwischen Klettverschluss und Maskenrahmen, damit kein Zug auf Ihre Nase ausgeübt wird.

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Maske darf nur mit Atemtherapiegeräten (CPAP oder BILEVEL) verwendet werden, die von Ihrem Arzt oder Atemtherapeuten empfohlen wurden. Verwenden Sie die Maske nicht, wenn das Atemtherapiegerät nicht eingeschaltet ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert sein.

Beachten Sie: Atemtherapiegeräte sind dazu vorgesehen, mit speziellen Masken verwendet zu werden, die Lüftungsöffnungen besitzen, damit die Luft aus der Maske entweichen kann. Wenn das Atemtherapiegerät eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert, kann die aus dem Gerät eingeatmete Luft durch die Lüftungsöffnungen entweichen. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist und nicht genug frische Luft in die Maske gelangt, kann keine Luft zurückgeatmet werden. Bei geringen Drücken ist es möglich, dass der Luftstrom an den Lüftungsöffnungen nicht ausreicht, um das gesamte Gas (CO₂) aus der Maske entweichen zu lassen. Ein Teil der ausgeatmeten Luft kann aber auch wieder eingeatmet werden.

- Wenn Sie zusätzlich Sauerstoff benutzen, dann muss bei abgeschaltetem Gerät die Sauerstoffzufuhr ebenfalls ausgeschaltet sein.

Beachten Sie: Wenn das Atemtherapiegerät nicht eingeschaltet ist und weiterhin Sauerstoff eingeleitet wird, dann sammelt sich innerhalb des Schlauches und des Gerätes Sauerstoff, der zu einem erhöhten Brandrisiko führt.

- Sauerstoff unterstützt Verbrennungsvorgänge. Rauchen Sie nicht und hantieren Sie nicht mit offenem Feuer, wenn Sauerstoff verwendet wird.
- Bei einer zusätzlichen Sauerstoffzufuhr variiert der Sauerstoffgehalt in Abhängigkeit vom Atemmuster des Patienten, der Druckeinstellung im Gerät, dem Maskensystem und dessen Leckage.
- Bei einigen Patienten kann es zu Hautrötungen kommen. Setzen Sie sich in diesem Fall mit Ihrem Arzt in Verbindung.

REINIGUNGSANWEISUNGEN

Die Nasenpolster, der Nasenpolstereinsatz und der Therapieschlauch sind täglich oder bei Bedarf zu reinigen.

- Waschen Sie die genannten Teile behutsam per Hand mit milder Seife und warmem Wasser. Benutzen Sie dabei keine Bleichmittel, Alkohol oder andere alkoholhaltige Mittel. Benutzen Sie ebenfalls keine Spülmittel oder Cremes.
- Spülen Sie die Teile gründlich mit klarem Wasser ab und lassen Sie alles an der Luft trocknen.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen und Verschleiß. Ersetzen Sie ggf. beschädigte oder verschlissene Teile.

Die Kopfbänder sind einmal wöchentlich oder bei Bedarf zu reinigen.


ENTSORGUNG

Die Nasal Pillow 4in1 Maske enthält keine gefährlichen Stoffe und kann daher mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Druck-Flow Kurve **Beachten Sie:** Die Maske verfügt zum Schutz vor Rückatmung über eine passive Belüftung gemäß ISO 17510-2. Aufgrund von Schwankungen im Herstellungsprozess kann die Durchflussrate variieren.

Druck	4 cmH ₂ O	8 cmH ₂ O	12 cmH ₂ O	16 cmH ₂ O	20 cmH ₂ O
Flow	15,7 LPM	20,4 LPM	25,1 LPM	29,0 LPM	33,7 LPM

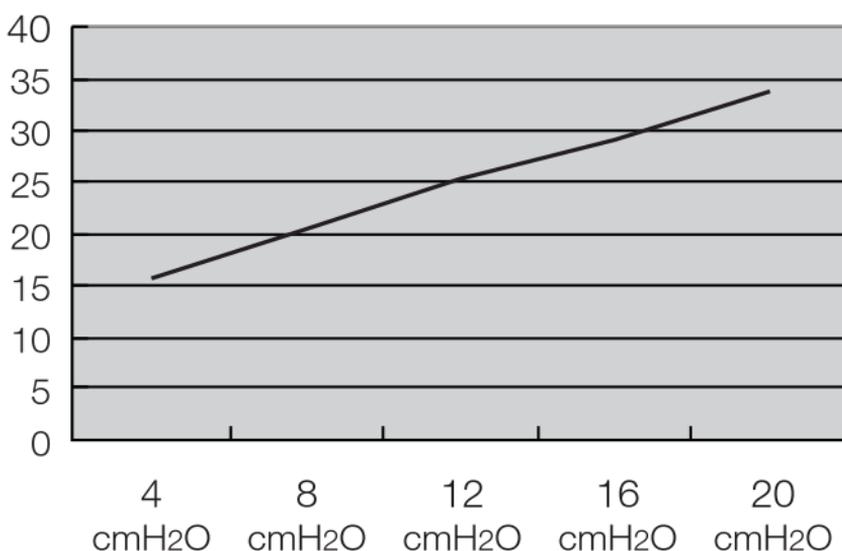

Standards CE-Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinie 93/42/EWG, Klasse IIa, ISO 1471, ISO 13485, ISO 10993-1 und ISO 17510-2.

Therapiedruck 4 bis 20 cmH₂O

Widerstand Abfall des gemessenen Druckes
bei 50 L/min: 2,1 cmH₂O;
bei 100 L/min: 8,0 cmH₂O

Lautstärke 27,2 dBA bei 10 cmH₂O
34,6 dBA bei 20 cmH₂O

Umgebungsbedingungen Lagertemperatur: 15°C bis 25°C Rel.
Feuchte (Lagerung): < 85°C

Nasal Pillow 4in1 Mask

User's Manual

SYMBOLS ON THE PACKAGE



Follow the user's manual



Date of manufacture



Product is latex-free



Batch designation



Article number



Use by



Product is only intended for use by a single patient

INTENDED USE


The nasal pillow mask is intended to provide an interface for Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) or bilevel system.

The mask to be used by adult patients (>66 lb/ 30 kg) for whom positive airway pressure has been prescribed. The mask is for single-patient re-use in the home environment and multi-patient re-use in the hospital / institutional environment.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN


- Easy to set, assemble, and maintain
- 4 different pillow sizes provide diverse compliance of the pitch of two nostrils
- 360° rotational elbow with extended silicone tube
- Quiet vent design

PARTS OF THE NASAL PILLOW 4 in1 MASK

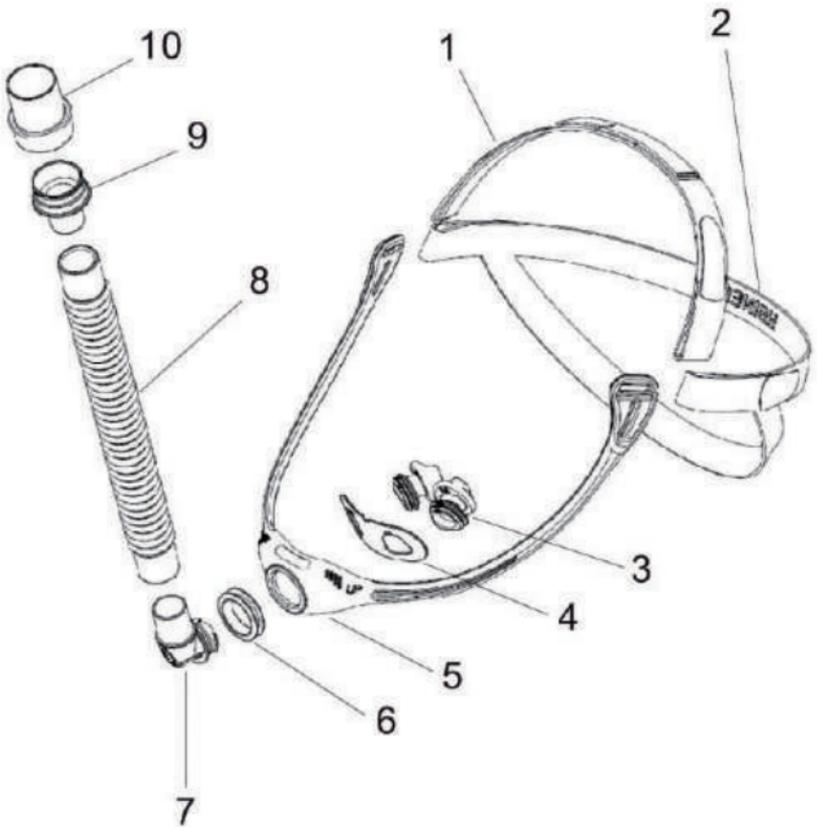


No.	Description
1	Top headgear
2	Rear headgear
3	Pillows (XS, S, M, L)
4	Platform
5	Main frame-silicone
6	Connector ring
7	Elbow connector
8	Silicone tube
9	Swivel connector
10	Tubing connector


FITTING YOUR NASAL PILLOW 4 in1 MASK

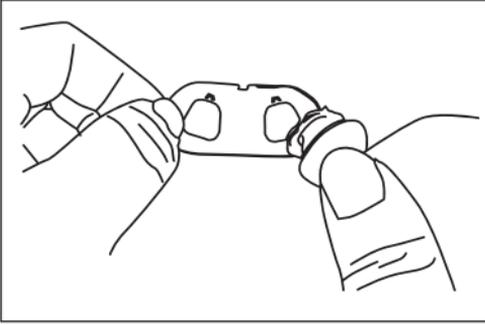

Attach the pillows on the platform. Make sure the tenons are fitted.

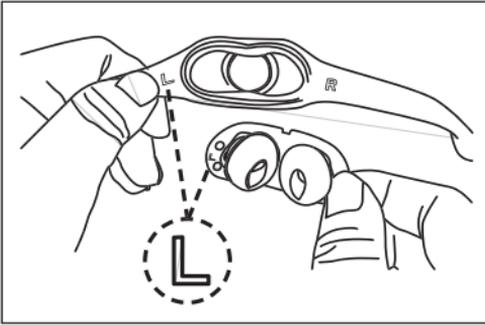


Attach the pillow set into the main frame. Make sure the platform concave is fitted to the main frame protrusion.

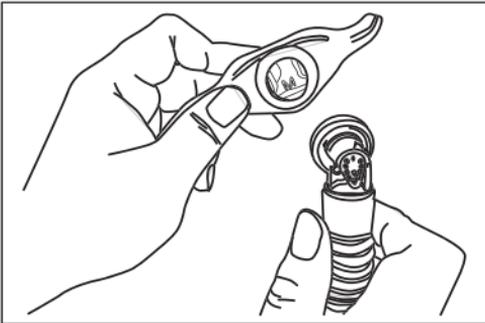


Plug the tube into the main platform.


FITTING YOUR NASAL PILLOW 4 in1 MASK

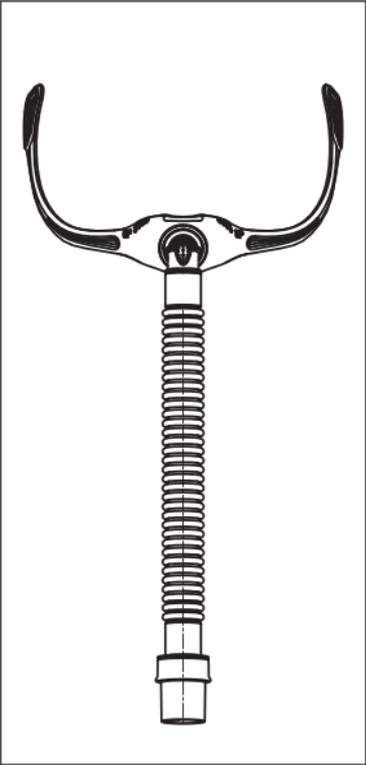

Front view

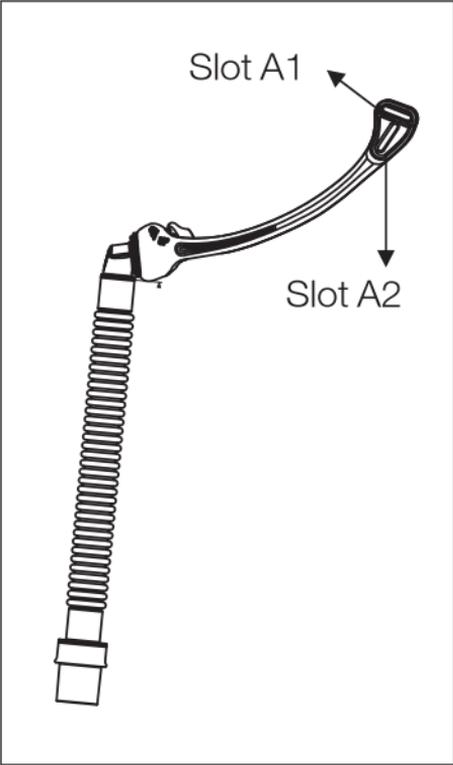


Lateral view

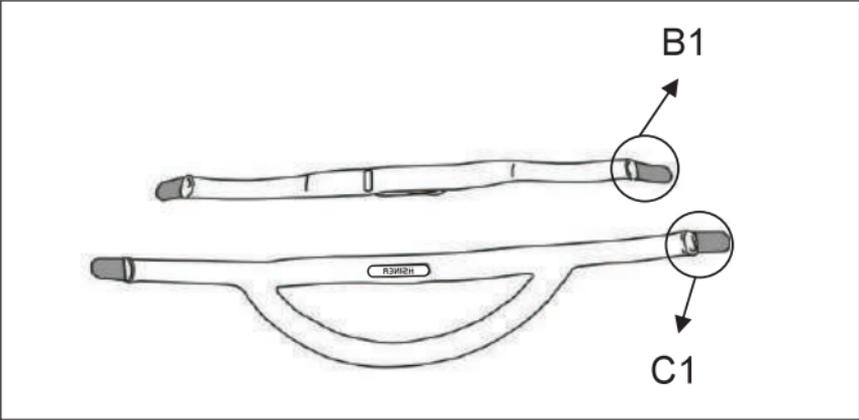


Head straps


FITTING YOUR NASAL PILLOW 4 in1 MASK

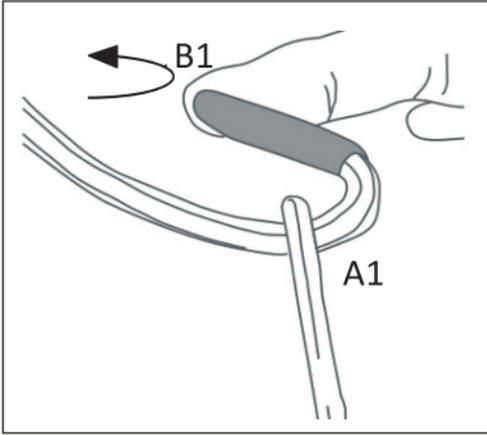

Insert the Velcro strap B1 into A1 and fasten it.

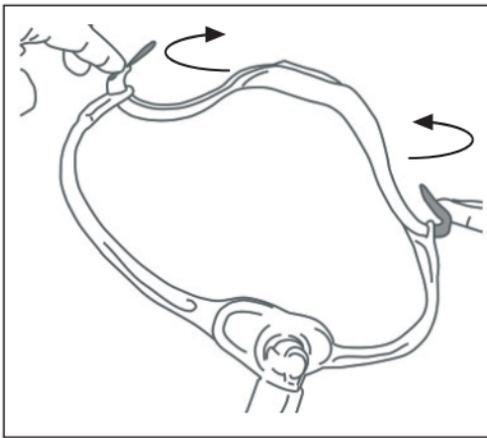


The same with the other side.

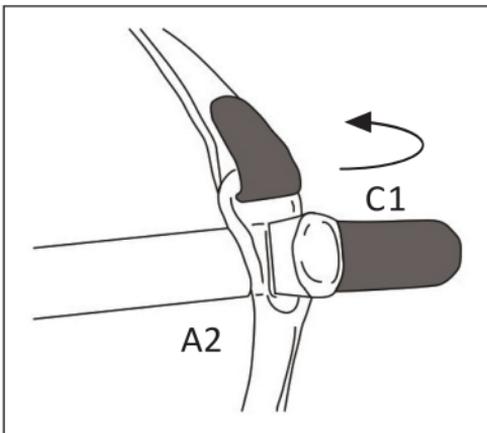


Insert the Velcro strap C1 into A2 and fasten it.

FITTING YOUR NASAL PILLOW 4 in1 MASK

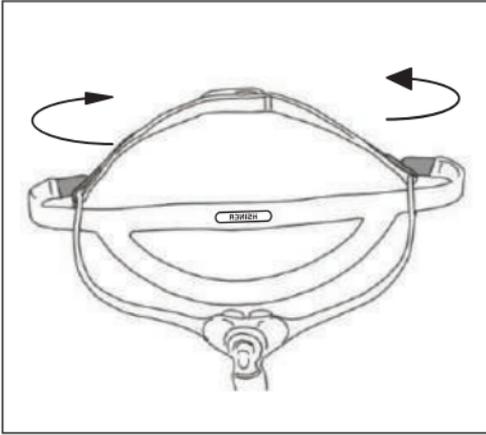

The same with the other side.

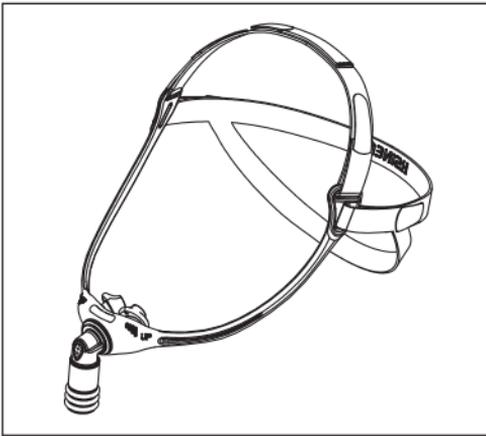

Both head straps are now adjusted.




Hold the pillows at your nose and pull the head-gear over your head.

FITTING YOUR NASAL PILLOW 4 in1 MASK



Adjust top straps (over tightening may cause excess pressure on your nose).

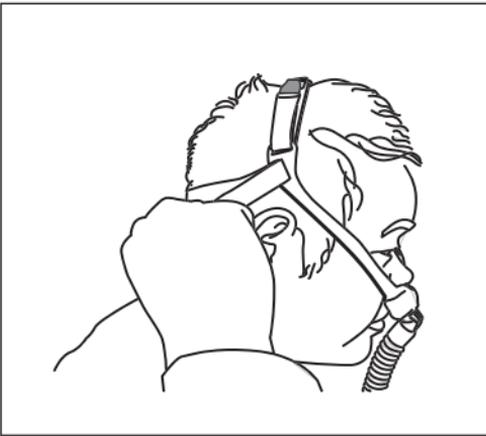

Adjust each end of the back strap.




Adjust the angle of the pillow to ensure it sits comfortably.


FITTING YOUR NASAL PILLOW 4 in1 MASK



Now the nasal pillow 4in1 mask is fitted and ready for use.

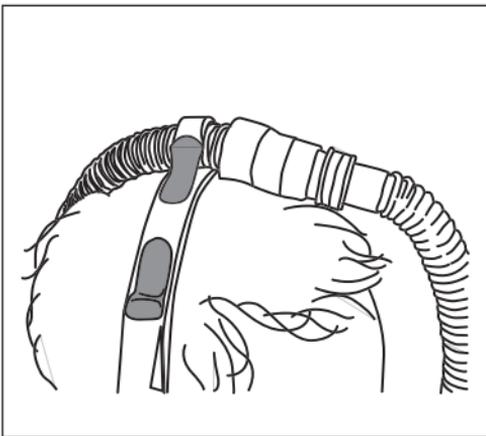

Fasten the air tubing through top strap, the tubing can be positioned in the center.

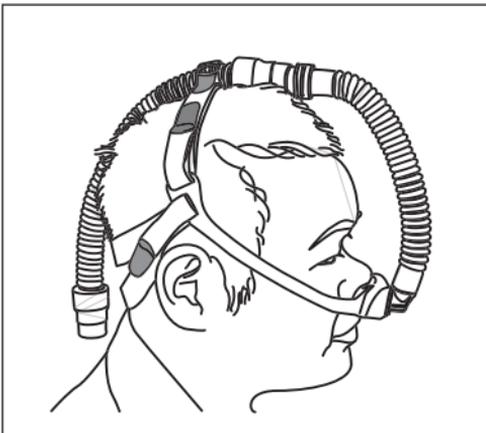

If the pillow mask pulls on your nose, increase length of tube between mask and top strap.

WARNINGS

This mask is designed for use with CPAP or bilevel systems recommended by your health care professional or respiratory therapist. Do not wear this mask unless the CPAP or bilevel system is turned on and operating properly. Do not block or try to seal the exhalation port.

Explanation of the Warning

CPAP systems are intended to be used with special masks with connectors which have vent holes to allow continuous flow of air out of the mask. When the device is turned on and functioning properly, new air from the device pushes the exhaled air out through the attached mask exhalation port. However, when the device is not operating, enough fresh air will not be provided through the mask, and exhaled air may be re-breathed. At low pressures, the airflow through the exhalation port may not be enough to clear all of the exhaled gas (CO₂) from the mask. You may breathe in some of the air that you have exhaled.

- If oxygen is used with the device, the oxygen flow must be turned off when the device is not operating.

Explanation of the Warning

When the device is not in operation, and the oxygen flow is left on, oxygen delivered into the ventilator tubing may accumulate within the device enclosure. Oxygen accumulated in the device enclosure will create a risk of fire.

- Oxygen supports combustion. Oxygen should not be used while smoking or in the presence of an open flame.
- At a fixed flow rate of supplemental oxygen flow, the inhaled oxygen concentration will vary, depending on the pressure settings, patient breathing pattern, nasal interface selection, and the leak rate.
- Some users may experience skin redness. If this happens, contact your health care professional.

CLEANING

Cleaning the Interface

The cushion, nasal interface, and tubing should be cleaned daily or as needed.

- Hand wash in warm water with a mild liquid dishwashing detergent. Do not use bleach, alcohol, or cleaning solutions containing alcohol. Do not use cleaners containing conditioners or moisturizers.
- Rinse thoroughly. Pat with a towel and air dry completely before use.
- Inspect all parts for damage or wear; replace if necessary.

Cleaning the Headgear

Hand wash the headgear weekly or as needed. Lay the headgear flat or line dry.

DISPOSAL


The nasal pillow mask does not contain any hazardous substances and may be disposed of with your normal household refuse.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pressure-Flow Curve

Note: The mask contains passive venting that meets the requirements for protection against rebreathing as specified in ISO 17510-2. As a result of manufacturing variations, the vent flow rate may vary.

Pressure	4 cmH ₂ O	8 cmH ₂ O	12 cmH ₂ O	16 cmH ₂ O	20 cmH ₂ O
Flow	15.7 LPM	20.4 LPM	25.1 LPM	29.0 LPM	33.7 LPM

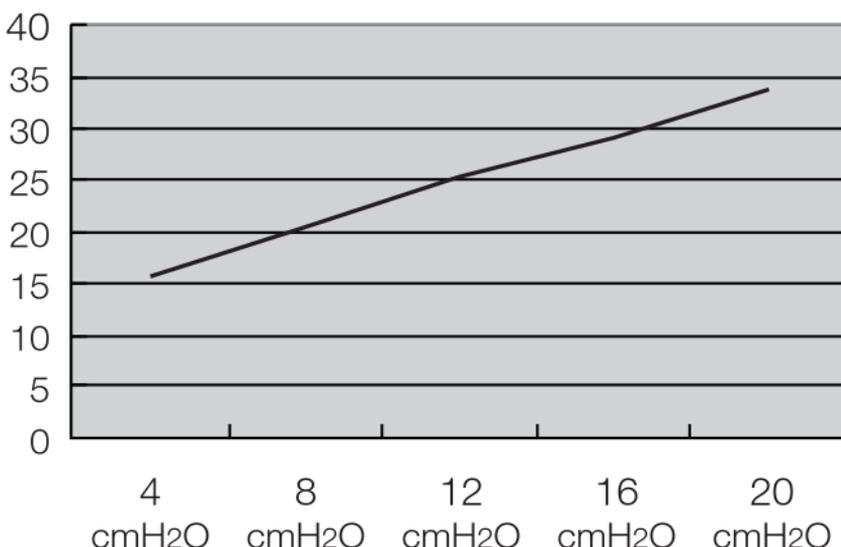

Standards	CE designation in accordance with EC directive 93/42/EEC, class IIa. ISO 14971, ISO13485, ISO 10993-1 and ISO 17510-2.
Therapy pressure	4 to 20 cmH ₂ O
Resistance	Drop in pressure measured at 50 L/min: 2.1 cmH ₂ O; at 100 L/min: 8.0 cmH ₂ O
Sound	27.2 dBA at 10 cmH ₂ O 34.6 dBA at 20 cmH ₂ O
Environmental conditions	Storage temperature: 15°C to 25°C Storage relative humidity: < 85%



HERSTELLER
HSINER Co.,Ltd.



312, Jhongshan Road, Shengang Dist.,
Taichung City 429, TAIWAN
Tel.: 886-4-25152480
Fax: 886-4-25152482
www.hsiner.com



EU REPRÄSENTANT

mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 511 39089530
Fax: +49 511 39089539
www.mdi-europa.com
info@mdi-europa.com

IMPORTER

HOFFRICHTER GmbH
Mettenheimer Str. 12/14
19061 Schwerin
Germany
Tel: +49 385 39925-0
Fax: +49 385 39925-35
www.hoffrichter.de
info@hoffrichter.de

